

図13 市販プール血清試料のクロマトグラム (1 g 使用)

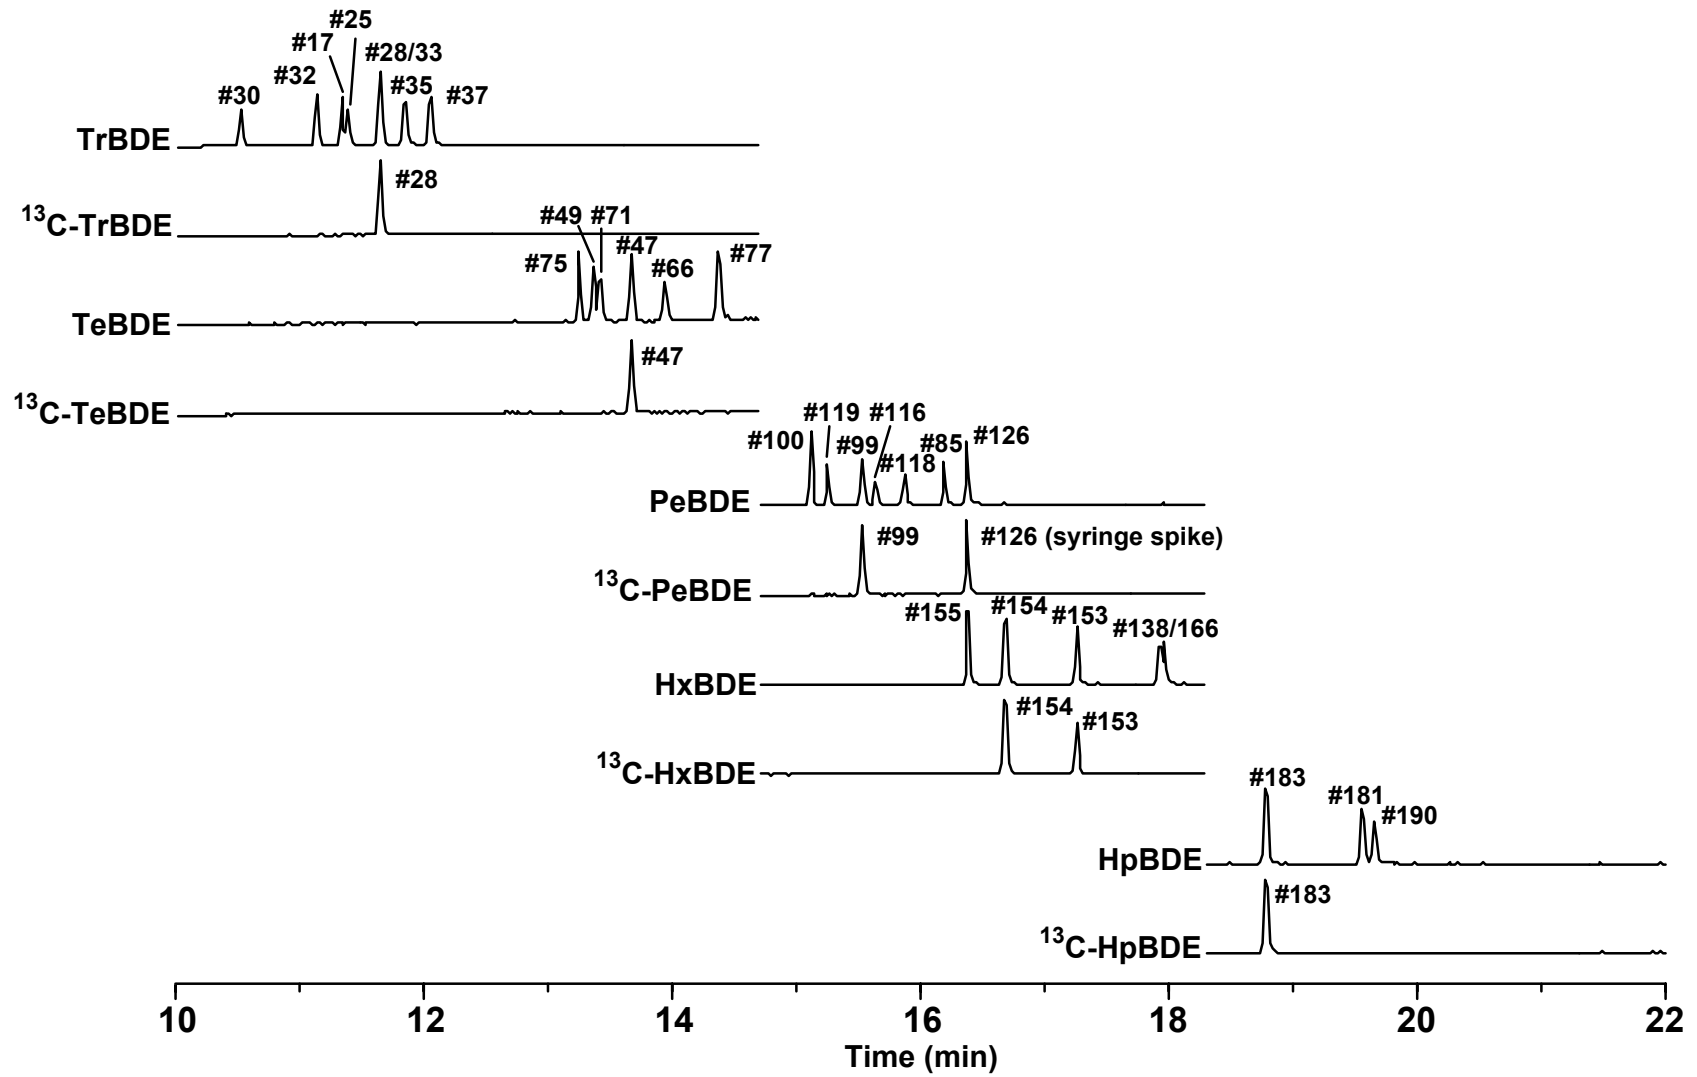


図14 標準溶液のクロマトグラム (各異性体濃度 1~2.5 ppb)

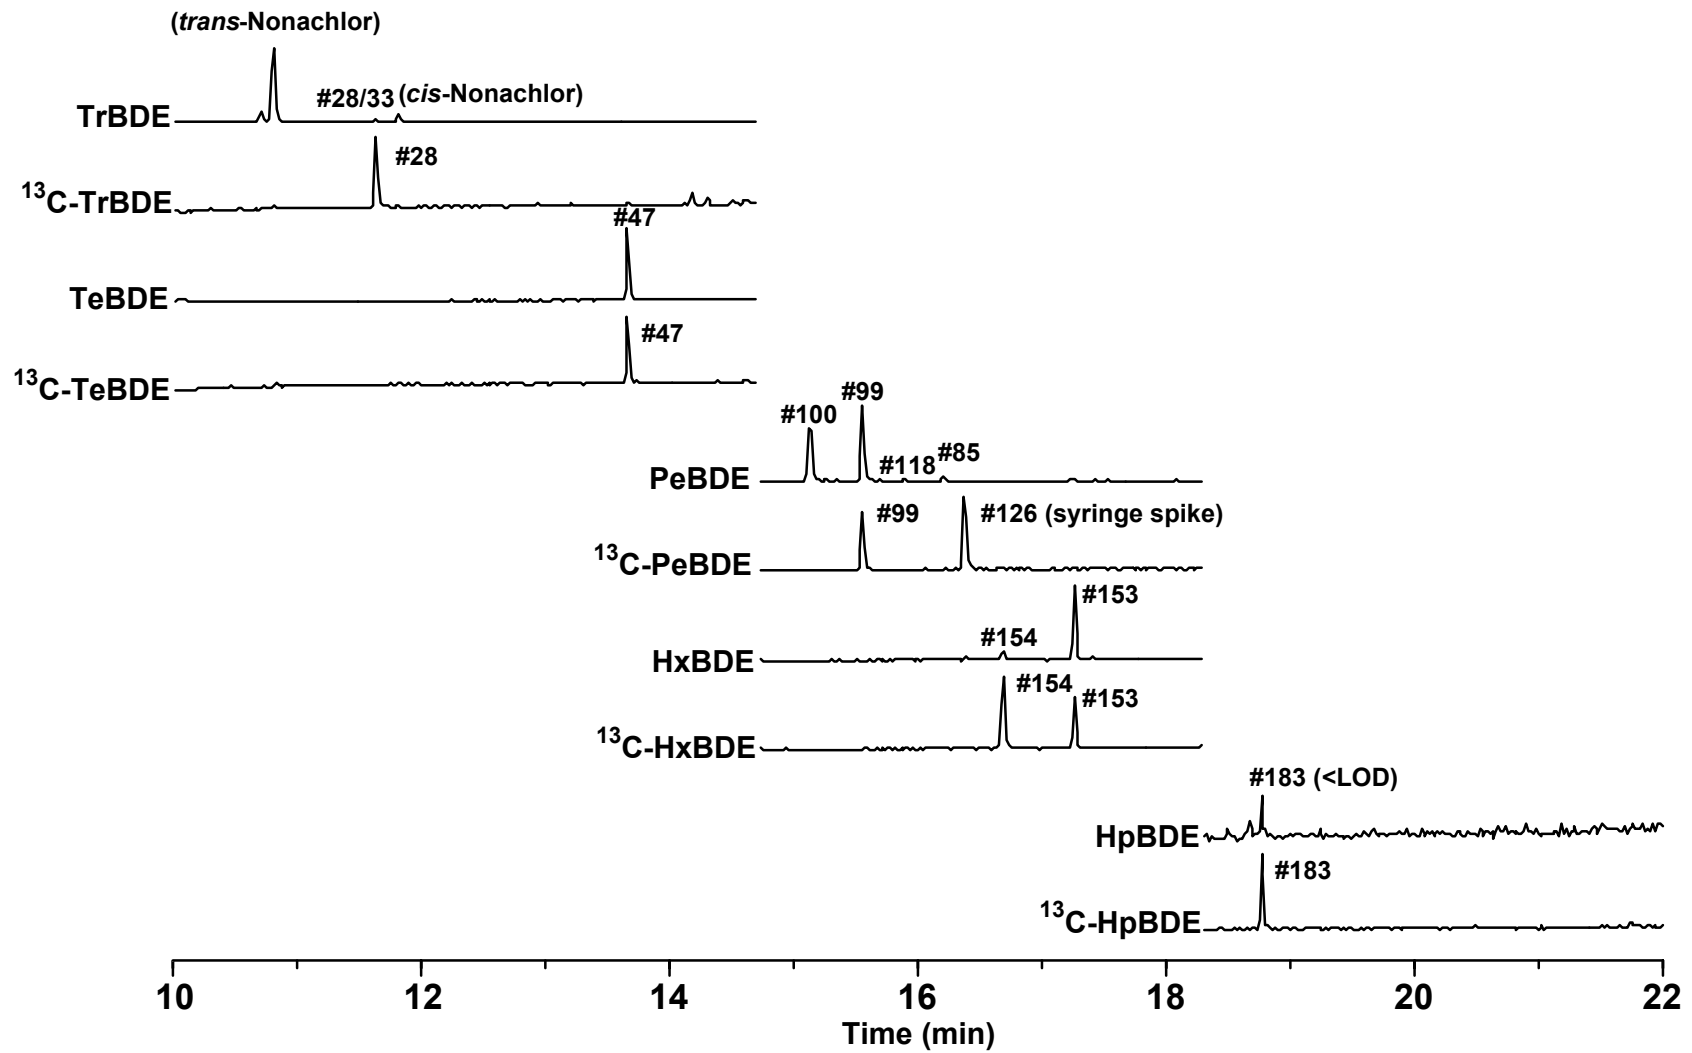


図 15 血清試料のクロマトグラム (YE100204005)

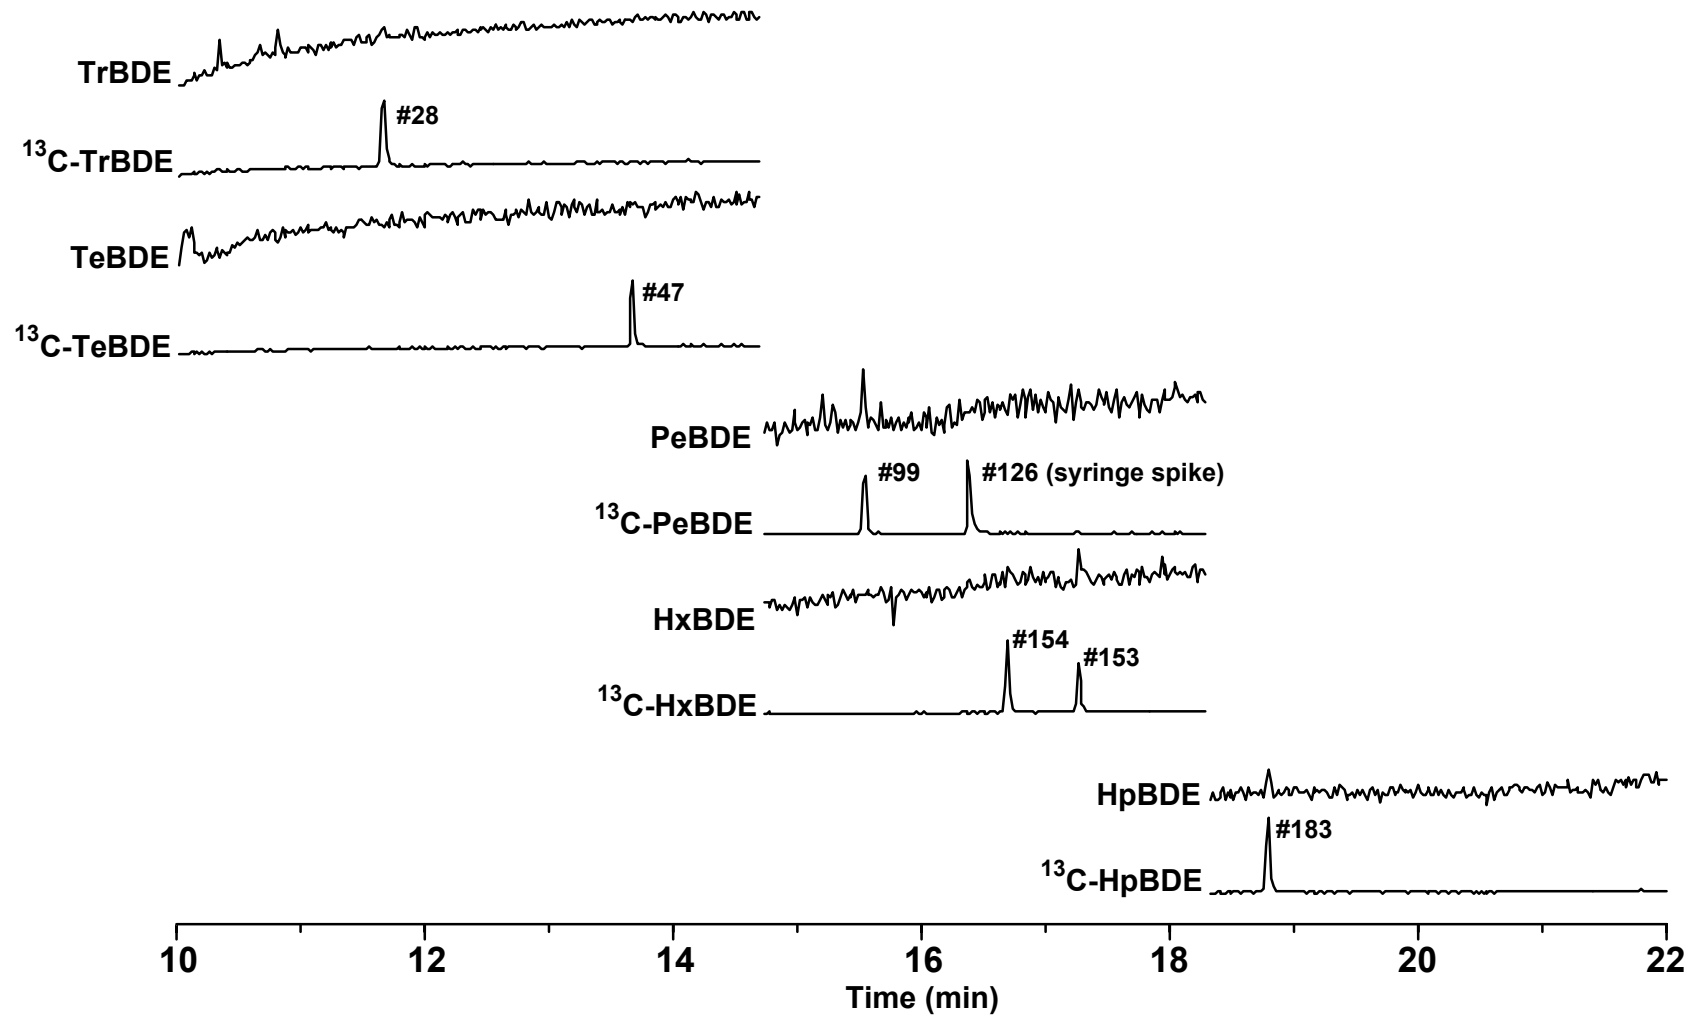


図 16 トラベルブランク試料のクロマトグラム

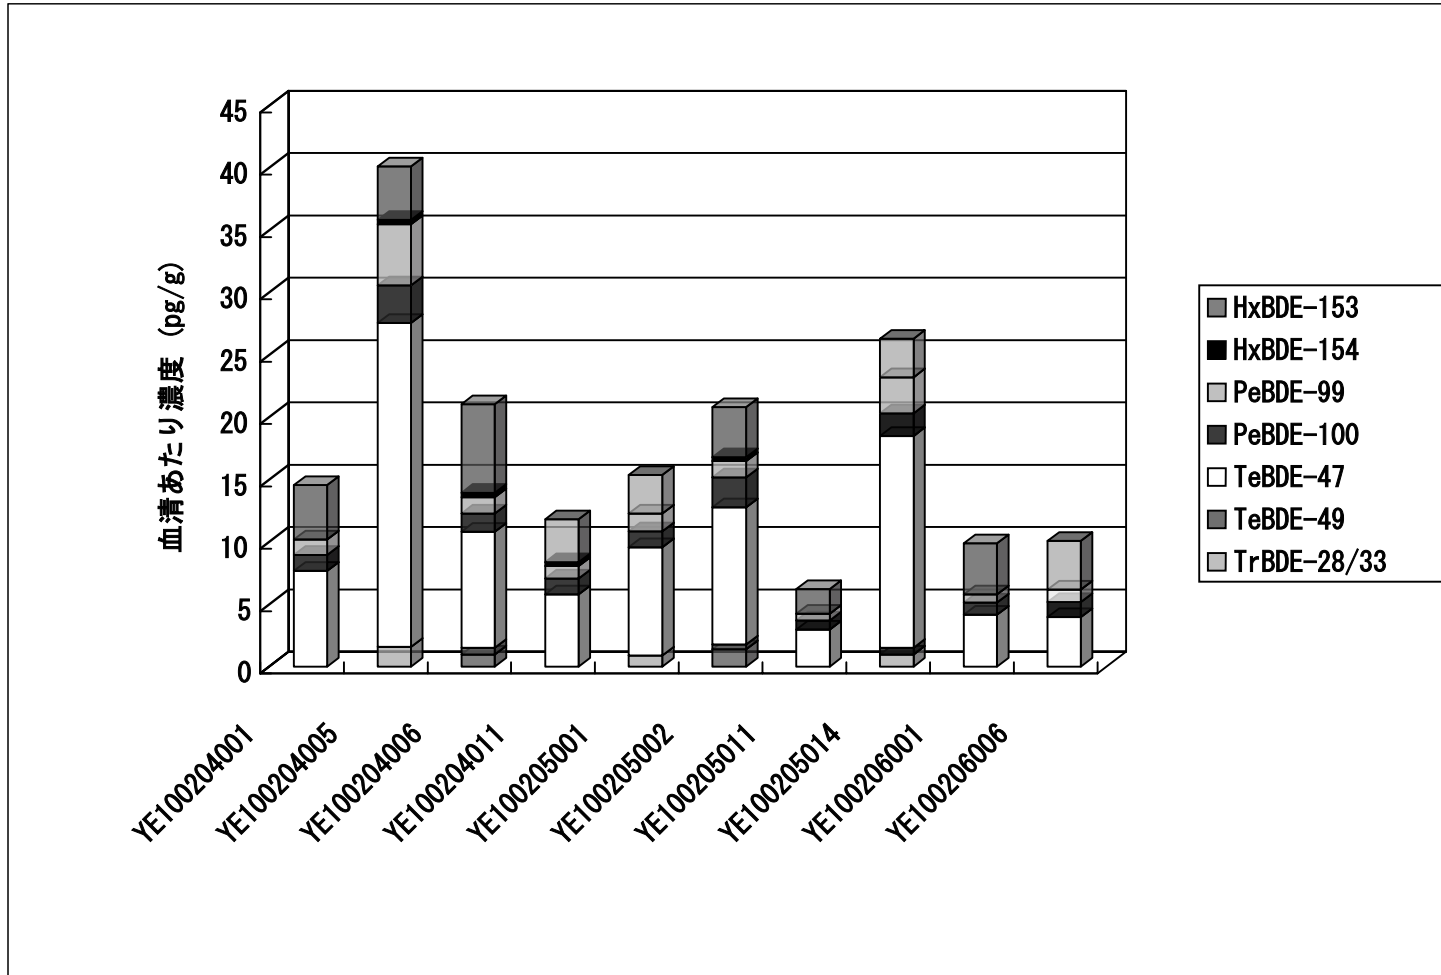


図 17 血清中 PBDEs 定量結果 (血清あたり濃度)

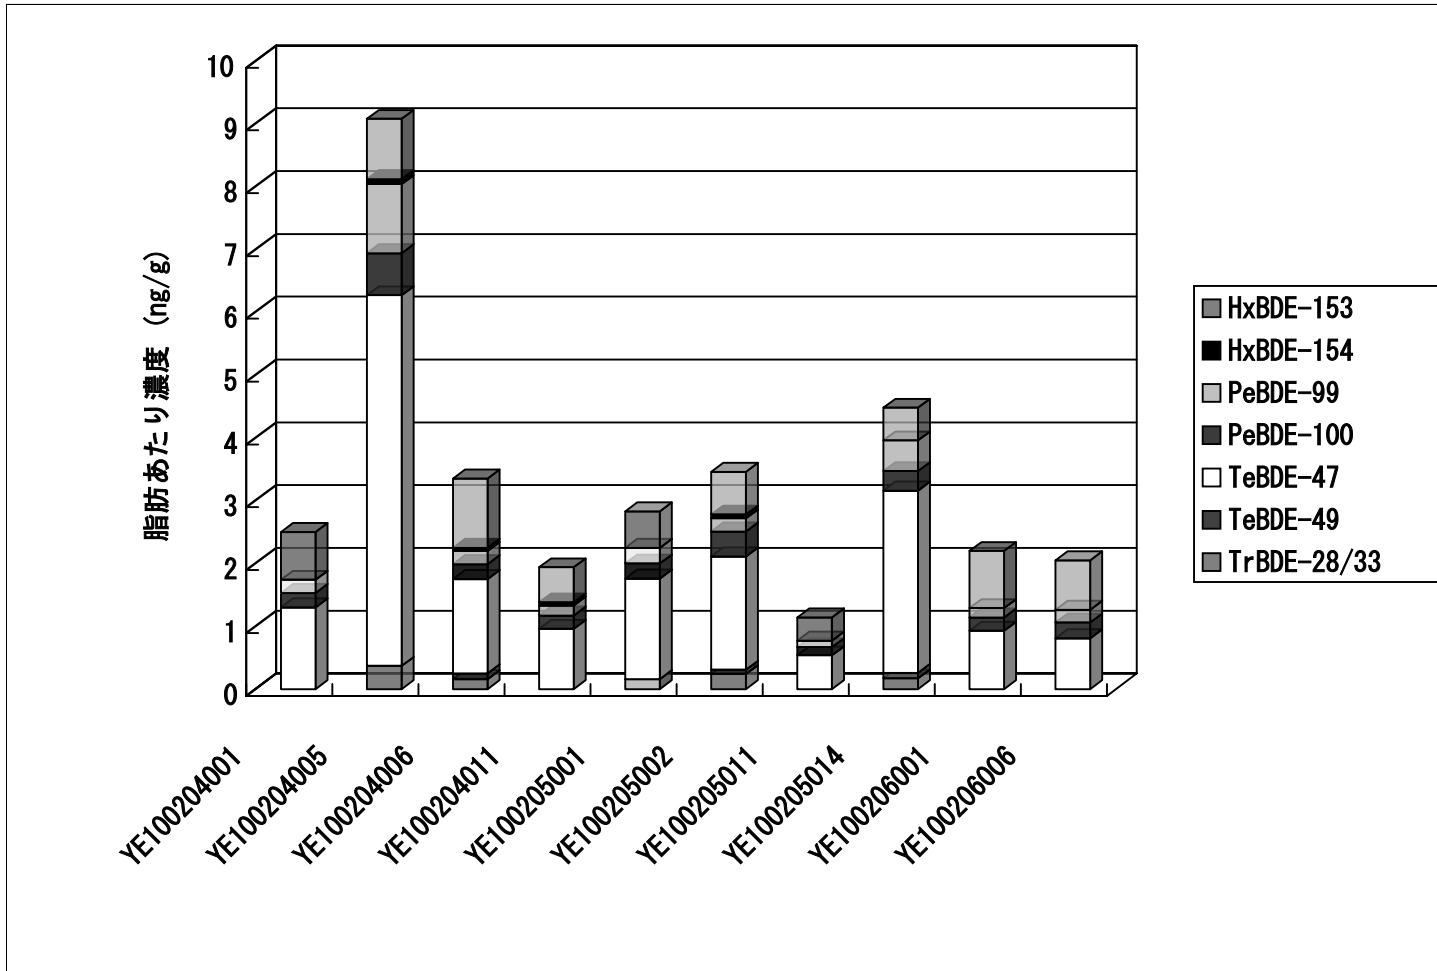


図 18 血清中 PBDEs 定量結果 (脂肪あたり濃度)